

ALL ARTWORK PRINTS PERCENTAGES OF
BLACK UNLESS OTHERWISE INDICATED

5.249"

5.249"

5.251"

playtex
baby™

Congratulations!
You now own the Diaper Genie®
Complete diaper disposal
system. To ensure your system
works best, we encourage you
to read these instructions
carefully and keep this guide
for future reference.

Your Diaper Genie® Complete comes with
a refill. When you are ready for your
first Diaper Genie® refill you can buy refills
that hold up to 270* diapers or you can
stock up on multi-packs and save.

The Diaper Genie®
7-layer refill with barrier
technology locks in germs.

For Optimal Performance,
Use Diaper Genie® Refills

© 2017 Edgewell. Playtex and all other trademarks are licensed or owned by Edgewell.
*Based on newborn-sized diapers.

diaper
genie®
COMPLETE



HELPFUL HINTS



93022190

diaper
genie®
COMPLETE

- ✓ Emptying the Diaper Genie® Complete pail frequently helps maintain room freshness.
- ✓ Like everything in baby's room, you should clean your pail periodically.
- For best results follow the instructions for use on your disinfecting and deodorizing cleansers.

Keep carbon filter out of reach of children.
If you have any questions or feedback on our products,
please contact us at 1-800-222-0453 or visit us at
www.playtexbaby.com

playtex
baby™

diaper
genie®
COMPLETE

All-in-One Diaper Disposal System
Sistema integrado de desecho de pañales

OWNERS MANUAL
MANUAL DEL PROPIETARIO
Keep this guide for future reference
Conserve este manual para referencia futura



10.50"

10.50"

playtex
baby™

diaper
genie®
COMPLETE

Sistema integrado de desecho de pañales

MANUAL DEL PROPIETARIO

Conserve este manual para referencia futura



SUGERENCIAS ÚTILES



93022190

diaper
genie®
COMPLETE

- ✓ El vaciado regular del balde del Diaper Genie Complete ayuda a mantener la frescura de la habitación.
- ✓ Al igual que todos los elementos en la habitación del bebé, debe limpiar el balde periódicamente. Para obtener mejores resultados, siga las instrucciones de limpiadores desinfectantes y desodorizantes.

Mantenga el filtro de carbón fuera del alcance de los niños. Si tiene alguna consulta o comentarios sobre nuestros productos, comuníquese al 1-800-222-0453 o visite www.playtexbaby.com

playtex
baby™

diaper
genie®
COMPLETE

!Felicitaciones!
Usted es ahora dueño del sistema de desecho de pañales Diaper Genie® Complete. Para asegurar el funcionamiento óptimo de su Diaper Genie® Complete, lo instamos a leer atentamente estas instrucciones y conservar este manual para referencia futura.


Su Diaper Genie® Complete viene con un repuesto. Cuando esté listo para su primer repuesto Diaper Genie®, puede comprar repuestos con capacidad de hasta 270* pañales o puede abastecerse de paquetes múltiples y ahorrar.

El repuesto Diaper Genie® de 7 capas con tecnología de barreras bloquea los gérmenes.

Para rendimiento óptimo, utilice los repuestos Diaper Genie®




© 2017 Edgewell. Playtex y todas las otras marcas comerciales están bajo licencia o son propiedad de Edgewell.
*En base a pañales para recién nacidos.

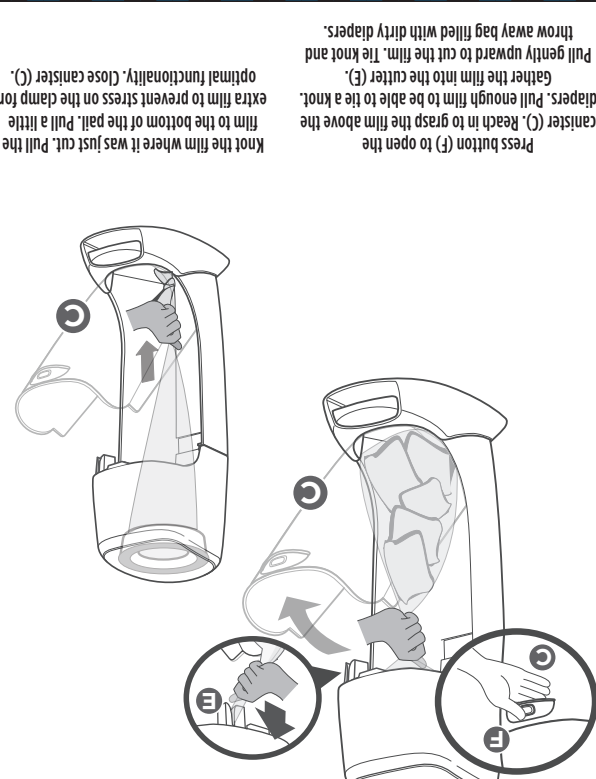



HOW TO EMPTY



HOW TO USE

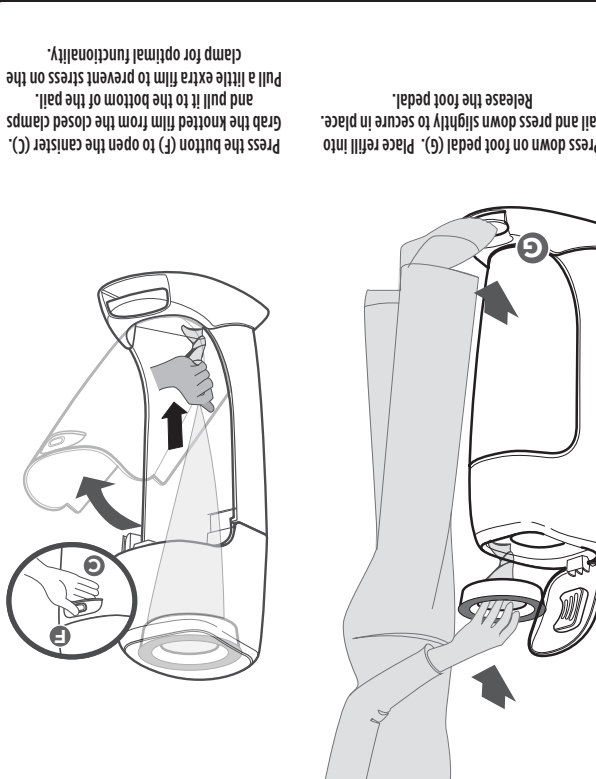

REPLACE REFILL

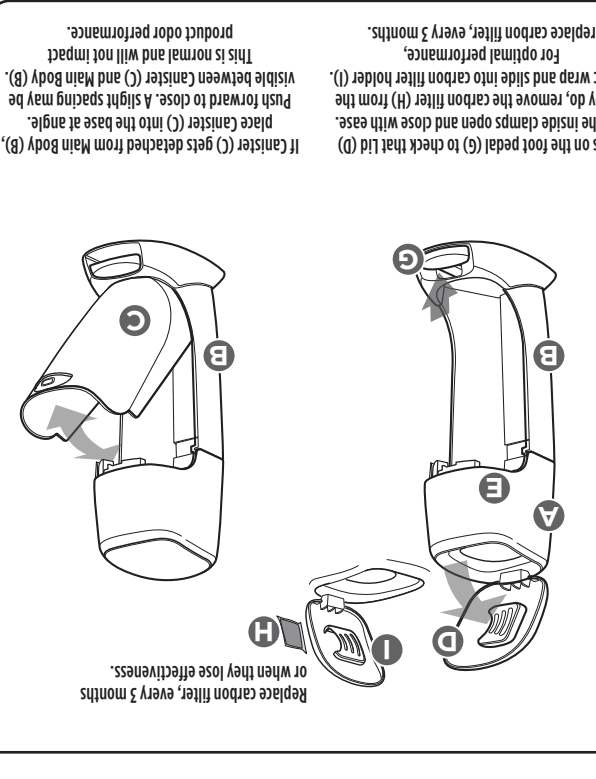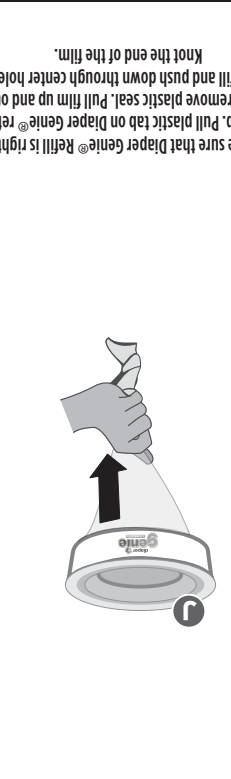

GETTING STARTED

- CONTENTS**
- A - Head
 - B - Main Body
 - C - Canister
 - D - Lid
 - E - Cutter
 - F - Diaper Genie Refill
 - G - Foot Pedal
 - H - Carbon Filter Holder
 - I - Carbon Filter
 - J - Diaper Genie Refill


- No assembly required!
- Pail is ready-to-use after removing tape adhesive on head (A) and (B)
- Then following these steps:

INDICE

- A - Cabezal
- B - Estructura principal
- C - Contenedor
- D - Tapa
- E - Cortador
- F - Botón del contenedor
- G - Pedal
- H - Filtro de carbón
- I - Portafiltro de carbón
- J - Repuesto Diaper Genie

PRIMEROS PASOS

- ¡No se requiere montaje!
- El balde está listo para uso después de quitar la cinta adhesiva sobre el cabezal (A) y siguiendo estos pasos a continuación:

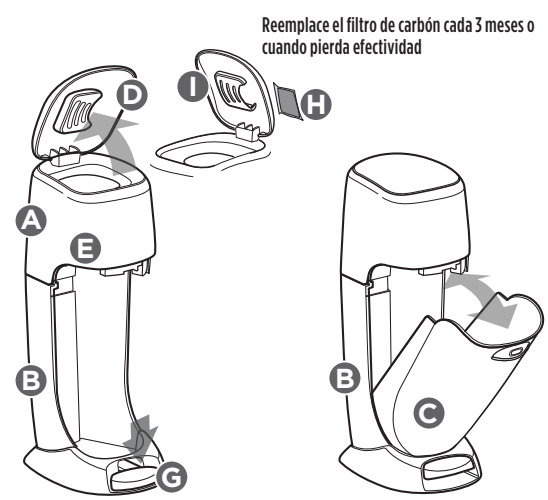

Presione sobre el pedal (G) para comprobar que la tapa (D) y las abrazaderas de adentro abren y cierran con facilidad. Si lo hacen, saque el filtro de carbón (H) de la envoltura de plástico y deslice dentro del portafiltro de carbón (I). Para un rendimiento óptimo, reemplace el filtro de carbón cada 3 meses.

Si el contenedor (C) se raja de la estructura principal (B), colóquelo (C) en ángulo a la base. Empuje hacia adelante para cerrar. Una ligera separación podría observarse entre el contenedor (C) y la estructura principal (B). Esto es normal y no va a influir en la eficiencia de producto sobre el olor.

CAMBIAR REPUESTO




Fíjese que el repuesto Diaper Genie® tenga el lado derecho hacia arriba. Jale la lengüeta plástica en el repuesto Diaper Genie® (J) para quitar el protector plástico. Jale la funda hacia afuera del repuesto y empuje a través del hueco central. Haga un nudo al extremo de la funda.

Haga presión en el pedal (G). Ponga el repuesto en el balde y presione suavemente hacia abajo para dejarlo bien colocado. Suelte el pedal.


Presione el botón (F) para abrir el contenedor (C). Agarre la funda amarrada desde las abrazaderas cerradas y jálela hasta el fondo del balde. Saque un poquito más de funda para evitar tensión en la abrazadera y así funcione mejor.

MODO DE USARLO

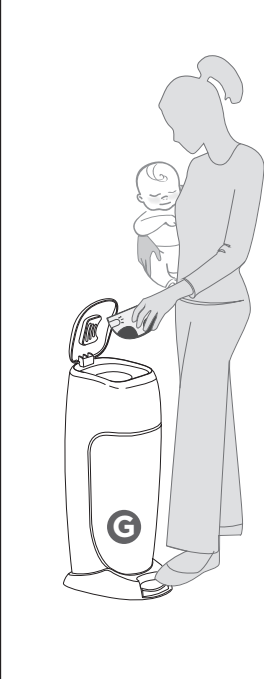

Presione el pedal (G) para abrir el sistema. Deposite el pañal enrollado sucio. Suelte el pedal para cerrar. Nota: Si la tapa no se abre, puede ser que la bolsa de repuesto Diaper Genie® necesite ser vaciada.

MODO DE VACIADO

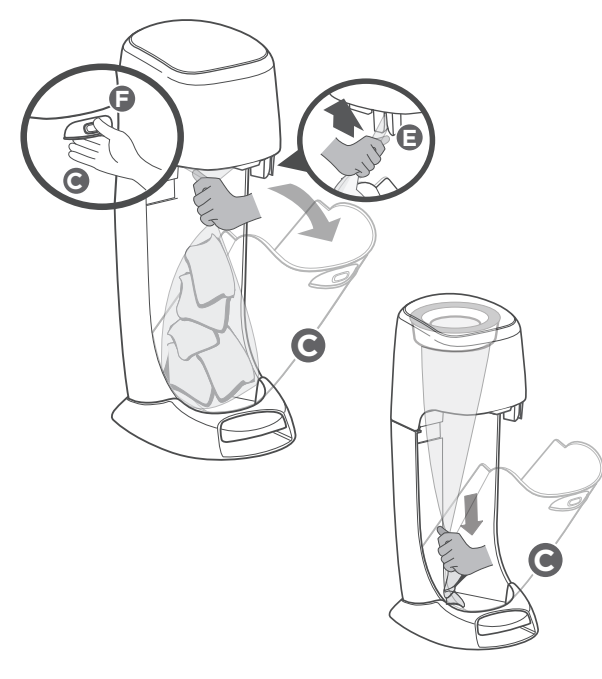

Presione el botón (F) para abrir el contenedor (C). Acérquese para agarrar la funda sobre los pañales. Extienda la funda suficiente para poder hacer un nudo. Inserte la funda en el contenedor (C). Jale suavemente hacia arriba para cortar la funda. Haga un nudo y desdoble la bolsa llena de pañales sucios.

FRONT PANEL

BACK PANEL

SGS	JOB NUMBER: 4519792	CUSTOMER: Edgewell Personal Care
	DESCRIPTION: 93022190 US-IC-DG Complete Fully Assembled Bklt X300933400 et al	
	OFFSET: ■ GRAVURE □ FLEXO □ SILKSCREEN □	DATE: 02/13/2017
	DISTORTION: H 1 000 W 4 000	LINE SCREEN: 175 LPI
	NO. OF COLORS: 1	PRINTER: RR Donnelley
	1st COLOR: BLACK	OPERATOR: CK
Please examine all files/film and compare to approved proof, color key, print, etc. for color and content before press run. If after reviewing materials, film/film is found inadequate, please contact us immediately. Our sole responsibility is for the film replacement.		
SGS International, 26 Pearl Street, Suite 202, Norwalk, CT 06850		

QC APPROVALS	COMMENTS / REVISIONS
SGS QC:	
COLOR / COLORBREAK / ELEMENT POSITION:	
TEXT:	

DIELINE#	Cycle No.
Edgewell™ PERSONAL CARE	02
ARCHIVE NAME / P-NUMBER: 93022190 US-IC-DG Complete Fully Assembled Bklt	
FILE NAME: US_IC_DG_1750924_02_93022190	
REFERENCED FILE: 93019648 US-IC-DG Diaper Genie Complete Booklet	
THIS ARTWORK HAS BEEN APPROVED BY EDGEWELL PERSONAL CARE ON 02/21/17 AND CAN BE USED TO VERIFY COPY CONTENT, UPC CODE AND COLOR BREAK	

100 90 75 50 25 10 5 3 2 1 0.8 0.4